

شماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Lab/۱۱۹۱
تاریخ و محل اعطا گواهینامه :
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - تهران
تاریخ صدور مجدد گواهینامه :
تاریخ اصلاح گواهینامه :
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that body:

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید مینماید که نهاد :

Moasese Tahghighat Ab-Vezarat Niro

موسسه تحقیقات آب - وزارت نیرو

Address: Shahid Abaspour Blvd., Hakimiyeh,
Tehran, I.R. IRAN.

Postal Code: 1658954381

Tel: +98(21)77000900

Fax: +98(21)77311959

Web Site: www.wri.ac.ir

نشانی: ایران، تهران، حکیمیه، بلوار شهید عباسپور

کد پستی: ۱۶۵۸۹۵۴۳۸۱

تلفن: ۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۰

دورنگار: ۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹

سایت اینترنتی: www.wri.ac.com

Has fulfilled the **INSO -ISO/IEC 17025:2017**
And is competent to carry out ☐ Test ☒ Calibration services
according to accreditation scope are listed in
2 page/s of annex.

الزامات استاندارد ایران - ایزو/آی ای سی ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ را رعایت نموده
است.


و صلاحیت انجام خدمات آزمون ☐ کالیبراسیون ☒ مطابق دامنه کاربردی که
جزئیات آن در ۲ برگ پیوست آمده است را داراست.


- Validity Of Accreditation Depends On Continuity Of Compliance With The Relevant Requirements And Obtaining The Approval Based On The Annual Surveillance Assessment.
- The Unique Identification Number Of This Accreditation Certificate And All Attachments Are The Same
- To Control The Originality Of This Certificate, Visit The Website Of NACI.(naciportal.inso.gov.ir)

• اعتبار تایید صلاحیت منوط به استمرار انطباق با الزامات مربوطه و
اخذ تاییدیه در ارزیابیهای مراقبتی سالیانه است.

• شماره انحصاری شناسایی در این گواهینامه تایید صلاحیت و کلیه
پیوستها یکسان است.

• جهت کنترل اصالت این گواهینامه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید
صلاحیت ایران مراجعه نمایید. (naciportal.inso.gov.ir)


Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT


اللهم عجل لوليک الفرج
دکتر سید محمود هاشمی
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

شماره انحصاری
 تایید صلاحیت
 NACI/Lab/۱۱۹۱
 تاریخ و محل اعطا گواهینامه :
 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - تهران
 تاریخ صدور مجدد گواهینامه :
 تاریخ اصلاح گواهینامه :
 تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :
 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت موسسه تحقیقات آب - وزارت نیرو

۱- دما و رطوبت

ردیف	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی	گستره	توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)
۱	دماسنج های مایع در شیشه، دو فلزی و سیستم پر شده	(-30 to 200) °C	0.13 °C
۲	دماسنج مقاومتی	(-30 to 200) °C (200 to 500) °C	0.13 °C 0.8 °C
۳	ترموکوپل	(-30 to 200) °C (200 to 500) °C	0.13 °C 0.8 °C
۴	محیط های دمایی (اون، انکوباتور)	(-30 to 200) °C	0.11 °C
۵	یخچال و فریزر	(-30 to 10) °C	0.11 °C
۶	محفظه رطوبت	(10 to 90) %RH at 25 °C	2 %RH
۷	دماسنج محیطی	(-10 to 70) °C	0.64 °C
۸	رطوبت سنج	(10 to 90) %RH	2.3 %RH
۹	سرعت سنج هوا Size: up to 4 inch	(0.3 to 10) m/s (10 to 40) m/s	0.1 m/s 2% rdg
۱۰	سرعت سنج آب Size: up to 5 inch	(0.05 to 5) m/s	0.02 m/s

۲- فشار

ردیف	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی	گستره	توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)
۱	فشارسنج و حسگر درون چاهی	(0 to 60) mH ₂ O	0.02 mH ₂ O
۲	بارومتر	(800 to 1100) mbar	15 mbar

اللهم عجل لولیک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری
تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۱۹۱

تاریخ و محل اعطا گواهینامه :
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - تهران

تاریخ صدور مجدد گواهینامه : ---

تاریخ اصلاح گواهینامه : ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت موسسه تحقیقات آب - وزارت نیرو

۳- ابعاد

ردیف	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی	گستره	توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)
۱	سطح سنج	up to 1000 mm	$(57+0.003 L) \mu m$ L:mm

۴- حجم

ردیف	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی	گستره	توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)
۱	باران سنج	h: up to 100 mm	1.2 ml

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation
 NACI/Lab/1191
 Initial Accreditation Date and Place: 2023.02.19-Tehran
 Renewal Date :
 Amendment Date:---
 Expiry Date:2026.02.19

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

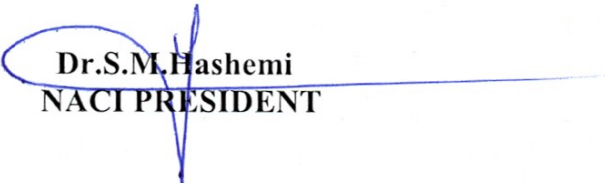
Accreditation Scope of Moasese Tahghighat Ab-Vezarat Niro

1-Temperature and Humidity

No.	Quantity, Measuring Instrument, Material Measure	Range	Capability Measurement and Calibration ($\pm$)
1	Liquid in Glass, Bimetal and Fill system Thermometer	$(-30 \text{ to } 200) ^\circ\text{C}$	$0.13 ^\circ\text{C}$
2	Resistance Thermometers	$(-30 \text{ to } 200) ^\circ\text{C}$	$0.13 ^\circ\text{C}$
		$(200 \text{ to } 500) ^\circ\text{C}$	$0.8 ^\circ\text{C}$
3	Thermocouple	$(-30 \text{ to } 200) ^\circ\text{C}$	$0.13 ^\circ\text{C}$
		$(200 \text{ to } 500) ^\circ\text{C}$	$0.8 ^\circ\text{C}$
4	Oven, Incubator	$(-30 \text{ to } 200) ^\circ\text{C}$	$0.11 ^\circ\text{C}$
5	Refrigerator and Freezer	$(-30 \text{ to } 10) ^\circ\text{C}$	$0.11 ^\circ\text{C}$
6	Humidity Chamber	$(10 \text{ to } 90) \% \text{RH}$ at $25 ^\circ\text{C}$	$2 \% \text{RH}$
7	Environment Temperature	$(-10 \text{ to } 70) ^\circ\text{C}$	$0.64 ^\circ\text{C}$
8	Hygrometer	$(10 \text{ to } 90) \% \text{RH}$	$2.3 \% \text{RH}$
9	Air Velocity Meter Size: up to 4 inch	$(0.3 \text{ to } 10) \text{ m/s}$	0.1 m/s
		$(10 \text{ to } 40) \text{ m/s}$	$2\% \text{ rdg}$
10	Water Velocity Meter Size: up to 5 inch	$(0.05 \text{ to } 5) \text{ m/s}$	0.02 m/s

2-Pressure

No.	Quantity, Measuring Instrument, Material Measure	Range	Capability Measurement and Calibration ($\pm$)
1	Pressure Sensors	$(0 \text{ to } 60) \text{ mH}_2\text{O}$	$0.02 \text{ mH}_2\text{O}$
2	Barometers	$(800 \text{ to } 1100) \text{ mbar}$	15 mbar


Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT

Identification Number of
Accreditation

NACI/Lab/1191

Initial Accreditation Date and

Place: 2023.02.19-Tehran

Renewal Date :

Amendment Date:---

Expiry Date:2026.02.19

Laboratory Accreditation Certificate

Annex


Accreditation Scope of Moasese Tahghighat Ab-Vezarat Niro

3-Dimensions

No.	Quantity, Measuring Instrument, Material Measure	Range	Capability Measurement and Calibration ($\pm$)
1	Level Meter	up to 1000 mm	$(57+0.003 L) \mu\text{m}$ L:mm

4-Volume

No.	Quantity, Measuring Instrument, Material Measure	Range	Capability Measurement and Calibration ($\pm$)
1	Rain Meter	h: up to 100 mm	1.2 ml


Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT